

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 439 DEL 27 GIU. 2019

OGGETTO: Procedura negoziata a mezzo di RDO sul Me.P.A. per la fornitura di attrezzature, suddivisa in 7 lotti con Fondi PSN 2016/17, Linea Progettuale 4 - Azione 4.2.10 per il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria - Servizio Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche aziendale. - Autorizzazione a contrarre.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO
PROPOSTA N. 502 DEL 20-06-2019

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
Collaboratore Amministrativo Prof. Ia
(Dr.ssa Sabrina Amato)
Dr.ssa Sabrina Amato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dr.ssa Pina Maria Petrucci)
Collaboratore Amministrativo P.Ie
(Dott.ssa Pina Maria Petrucci)

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
(Dr.ssa Lorena Di Salvo)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (A.L.L. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione F. Fondo PSN 2016/17 C.E. / C.P.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
(Dr. Achille Parentino)

Coll. Amministrativo
Coll. Amministrativo Luca Calogera Bato

Da notificare a: UOC PROVVEDITORATO

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 21-06-2019

L'anno duemiladiciannove il giorno VENTI SETTE del mese di GIUGNO nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Giulio Santonocito, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.186/Serv.1/S.G. del 04/04/2019, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante Dott.ssa PATRIZIA TEDESCO adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore della U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO, dott.ssa Loredana Di Salvo

Visto l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 667 del 03/05/2017 ed approvato con D.A. n. 1082 del 30/05/2017, di cui si è preso atto con Delibera n. 816 del 09/06/2017;

Premesso:

- che con DDG n. 400 e n. 401, entrambi dell' 8/3/2018, l'Assessorato Regionale alla Salute ha assegnato al Servizio Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche di questa Azienda dei Fondi Regionali per la linea 4 dei PON 2016/17, distinti nel PSN 2016 e 2017 per un importo complessivo pari ad € 73.630,00 per l'acquisto di attrezzature;
- che pertanto, con nota prot. n. 61208 del 4/4/2019 il Direttore del Servizio Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, dott. Izzo, ha formulato richiesta per l'acquisto di attrezzature, per una spesa complessiva stimata in € 53.372,46; (All. n. 1);
- che in data 4/02/2019 è stato pubblicato sul sito web aziendale indagine di mercato prot. n. 97715, al fine di consentire alle ditte interessate di manifestare interesse alla fornitura di che trattasi mediante apposito preventivo di spesa (All. n. 2);
- che nel termine ivi indicato nessuna ditta ha dato riscontro;

Atteso:

- che, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 commi da 548 a 550, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), la categoria merceologica del materiale sanitario richiesto non rientra tra quelle previste dal DPCM del 11.07.2018 (entrato in vigore il 16.08.2018) emanato ai sensi del D. L. 66/2014, convertito con L. 89/2014, in relazione all'individuazione delle categorie di beni e servizi, nonché delle soglie al superamento delle quali, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti, in via esclusiva, ad approvvigionarsi per il tramite della centrale regionale di committenza (soggetto aggregatore di riferimento), ovvero della Consip;
- che, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del D. L. 52/2012, convertito con L. 94/2012, e dall'art. 15, comma 13, lett. d), del D.L. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, è stato consultato il portale www.acquistinretepa.it per gli acquisti tramite Consip, e non risultano al momento convenzioni attive per la fornitura di che trattasi e che il materiale sanitario richiesto può essere oggetto di procedure di acquisto sul mercato elettronico del suddetto portale;

Visti:

- l'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 che disciplina l'acquisizione delle forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ed in particolare il comma 2 lett. b) per gli affidamenti di importo da 40.000 euro sino alla soglia comunitaria (€ 221.000,00), ed il comma 6 per gli acquisti tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione avvalendosi della piattaforma Consip/Me.PA.;
- le Linee Guida ANAC di attuazione del D. Lgs. 50/2016 - n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", adottata con delibera della medesima Autorità n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01.03.2018;

Ritenuto:

- di autorizzare, ai sensi della normativa sopra citata, l'esperimento di apposita procedura negoziata a mezzo RDO/MEPA aperta (Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato

Elettronico, previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta - Bando Beni Forniture specifiche per la sanità) per l'affidamento della fornitura di attrezzature, suddivisa in 7 lotti, occorrenti al Servizio Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell'ASP di Agrigento per un importo complessivo presunto di € 50.703,83 = + IVA, desunto dall'allegata richiesta decurtato del 5%, con le specifiche di cui all'allegato capitolato tecnico elaborato dal Direttore del Servizio Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche aziendale;

- di approvare l'allegato capitolato tecnico elaborato dal Direttore del Servizio Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche aziendale, nonché il documento denominato "Condizioni particolari di contratto", che disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA., con allegato il capitolato tecnico elaborato dal Direttore del Servizio Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (All. n. 3) dandosi atto che il criterio di aggiudicazione previsto è quello del minor prezzo, in quanto trattasi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, con caratteristiche standardizzate ex art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016, introdotto dal D.L.32/19;

DATO ATTO che l'onere derivante dal presente atto deliberativo, ammontante presuntivamente ad € 50.703,83 = + IVA, oltre alle competenze interne ex art. 113 D.Lgs. 50/16, grava sui Fondi PON - PSN 2016/17, Linea Progettuale 4 - Azione 4.2.10, riservandosi di provvedere alla quantificazione della spesa effettiva, derivante dall'esperimento della procedura, con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura in oggetto sulla base dell'effettiva risultanza di gara;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1) **AUTORIZZARE**, ai sensi della normativa citata in premessa, l'esperimento di apposita procedura negoziata, a mezzo RDO/MEPA aperta (Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico, previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta - Bando Beni Forniture specifiche per la sanità) per l'affidamento della fornitura di attrezzature, suddivisa in 7 lotti, occorrenti al Servizio Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell'ASP di Agrigento per un importo complessivo presunto di € 50.703,83 = +IVA con le specifiche di cui all'allegato capitolato tecnico elaborato dal Direttore del Servizio Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche aziendale;

2) **APPROVARE** l'allegato capitolato tecnico elaborato dal Direttore del Servizio Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche aziendale, nonché il documento denominato "Condizioni particolari di contratto" (All. n. 4), che disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA., dando atto che il criterio di aggiudicazione previsto è quello del minor prezzo, previo giudizio di conformità tecnica, per le motivazioni indicate in premessa;

3) **DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito web aziendale www.aspag.it amministrazione trasparente sezione bandi di gara e contratti, in conformità all'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e all'art. 29 del D. Lgs. 50/2016;

4) **DARE ATTO** che l'onere derivante dal presente atto deliberativo, ammontante presuntivamente ad € 61.858,67, IVA inclusa, oltre alle competenze interne ex art. 113 D. Lgs. 50/16, grava sui Fondi PON - PSN 2016/17, Linea Progettuale 4 - Azione 4.2.10, riservandosi di provvedere alla quantificazione della spesa effettiva, derivante dall'esperimento della procedu-

ra, con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura in oggetto sulla base dell'effettiva risultanza di gara;

- 5) CHE l'esecuzione della deliberazione verrà curata dal Servizio Provveditorato;
- 6) DARE ATTO che i documenti citati nel presente provvedimento e non allegati allo stesso, sono custoditi agli atti del Servizio proponente, visionabili e fruibili di chi vi abbia interesse;

7) MUNIRE la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, onde garantire il regolare approvvigionamento del materiale sanitario indispensabile al regolare funzionamento dei reparti interessati senza soluzione di continuità.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore della U.O.C. PROVVEDITORATO
dott.ssa Loredana Di Salvo

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere

favore

Data

16/06/2019

Il Direttore Amministrativo
Dott. Alessandro Mazzara

Parere

favore

Data

25/06/2019

Il Direttore Sanitario
Dott. Gaetano Mancuso

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla dott.ssa Loredana Di Salvo, Direttore della U.O.C. Provveditorato, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come

sopra formulata e sottoscritta dalla dott.ssa Loredana Di Salvo della U.O.C. Provveditorato, *CON RISERVA DI RIDEDETERMINARE, CON SUCCESSIVA DELIBERAZIONE, LA MISURA DELL'ACCANTONAMENTO PER INCENTIVI EX ART 43 D.LGS N.50/16-*

Il Direttore Amministrativo
Dott. Alessandro Mazzara

Il Direttore Sanitario
Dott. Gaetano Mancuso

Il DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

Il Segretario verbalizzante
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
UFFICIO DI SEGRETARIA, PROPOSTE
DI ATTI E ANUMA
Dott.ssa Patrizia Tedesco



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Sede legale : Viale della Vittoria n. 321 - 92100 Agrigento

Partita IVA - Codice Fiscale : 02570930848

Dipartimento di Prevenzione Veterinaria

Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

Viale della Vittoria n.321 Agrigento

Prot.n. 00 61208 del 04/04/2019

Fax e tel. 0922/407179
EMail : antonio.izzo@aspag.it

Al Servizio Provveditorato
Servizio Acquisizione Beni e Servizi

Epc

Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione
nella qualità di Coordinatore Aziendale dei progetti aziendali con Fondi Vincolati

Al Responsabile Formazione e politiche del personale
nella qualità di Referente Unico Aziendale dei Progetti Aziendale con Fondi Vincolati

Al Direttore SEFP

Al Responsabile Servizio Controllo di Gestione

LORO SEDI

Oggetto: richiesta acquisto attrezzature con Fondi PSN 2016/2017 - Linea Progettuale 4- Azione 4.2.10 - riformulata

L'assessorato Regionale della Salute con DDG n. 400 e 401 del 08/03/2018 ha assegnato, al Servizio Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, i Fondi Regionali alla linea 4 dei PON 2016/2017, distinti nel PSN 2016 per € 122.380,00 e PSN 2017 € 52.450,00, di cui € 73.630,00 (totale) per l'acquisto di attrezzature.

Per quanto sopra esposto, si chiede l'acquisto urgente delle seguenti attrezzature:

1. N° 5 autoclavi per la sterilizzazione di ferri chirurgici; (€ 1.700,00 circa ciascuna) € 8.500,00

caratteristiche tecniche:

- (Vtaggio (V) Freq. (Hz) 220/240V, 50/60 Hz;10A
- Dimensione della camera: 17 x 32 cm
- Fusibili principali: F16A/400V
- Potenza nominale: 1500W
- Temperatura di sterilizzazione: 121 °C / 134 °C
- Capacità serbatoio acqua distillata: 2.5 litri approx.
- Temperatura ambientale funzionamento: 5 - 40 °C
- Dimensioni esterne: 414 x 365 x 530 mm
- Peso netto dell'Autoclave: 34.5 Kg
- Livello potenza sonora :<70 dB
- Umidità relativa ambiente di funzionamento: 80% massimo
- Pressione atmosferica: 76kPa - 106kPa).

2. N° 5 apparecchi per esame emocromo completo, € 30.000,00

caratteristiche tecniche:

- Analizzatore per ematologia BC-2800Vet** Mindray Analizzatore automatico per ematologia compatto con conta differenziata di WBC per cani e gatti. 19 parametri + 3 istogrammi per cane, gatto, cavallo, topo, ratto e coniglio. 12 parametri + 3 istogrammi per suino, bovino, bufalo, pecora, capra e cammello.
- Possibilità di archiviare fino a 10.000 risultati analisi.

- c) Predisposizione per 12 banche dati (cane, gatto, cavallo, topo, ratto, coniglio, suino, bovino, bufalo, capra, pecora e cammello) + 4 programmabili a richiesta.
- d) Sistema di pulizia automatico della sonda aspiratrice .
- e) Sistema di pulizia interno ed esterno automatico.
- f) Reagenti senza cianide per evitare contaminazioni nell'ambiente.
- g) Sistema di calcolo indipendente per ogni specie animale per assicurare l'alta precisione.
- h) Programma di calibrazione interamente automatico.
- i) Caratteristiche tecniche : - Parametri : WBC, RBC, HGB, MCV, MCH, MCHC, RDW, HTC, PTL, MPV, PDW, PCT. Ulteriori parametri per cane, gatto, cavallo, topo, ratto e coniglio
- j) Istogramma per WBC, RBC, PTL - Principi di analisi : impedenza elettrica per il calcolo dei parametri e metodo SFT per l'emoglobina - Volume del campione : diluito 20uL, puro 13uL - Capacità lavorativa : 25 campioni analizzati per ora - Schermo TFT 7,5" a colori, visualizza tutti i parametri e gli istogrammi. Risoluzione: 640 x 480 - Menu : Calcolo, Visualizzazione Dati, Controllo Qualità, Impostazioni, Servizi, Calibrazione, Spegnimento - Stampante termica interna ed esterna (opzionale), collegamento tastiera - Software per PC semplice da usare - Alimentazione : AC 220V + 15, 50/60 + 1 Hz o AC 110V + 15, 50/60 + 1 Hz - Dimensioni : 437 mm (h) x 322 mm (p) x 386 mm (l) - Peso 17,9 kg;

3. N° 5 elettrobisturi con accessori (completo di manipolare) per chirurgia monopolare: (circa 960, 00 ciascuno) € 4.800,00;

Caratteristiche tecniche:

Elettrobisturi SU 140-MPC

- Elettrobisturi a tecnologia digitale con microprocessore di controllo. L'MPC System è un sofisticato sistema di controllo dei parametri di funzionamento, che garantisce prestazioni e sicurezza altrimenti inottenibili. Il sistema è dotato di una completa autodiagnosi all'accensione e di un controllo in tempo reale durante l'uso, in effetti il funzionamento viene bloccato automaticamente in caso di guasti. Le potenze erogate sono controllate mediante microprocessore, ADC System e bloccate in caso di guasti, impedendo una potenziale erogazione di potenza superiore a quella selezionata. Il sistema controlla anche le correnti di dispersione A.F. verificando eventuali disadattamenti dell'impedenza e riducendo automaticamente la tensione d'uscita a livelli di sicurezza.

Segnali acustici e luminosi :

- taglio (suono grave, luce gialla)
 - coagulazione (suono acuto, luce blu)
- Dotato di 5 correnti con impulso iniziale controllato elettronicamente per ottenere migliori con l'utilizzo di potenze più basse :
- CUT : senza modulazione, per taglio puro senza emostasi, 140 W a 500 Ohms
 - BLEND : combinazione modulata di corrente da taglio ed emostasi per taglio coagulante, 120 W a 500 Ohms
 - COAG : ad alto voltaggio, per coagulazione anche senza contatto e con forte effetto superficiale, 120 W a 500 Ohms
 - MICRO : a basso voltaggio, 60 W a 200 Ohms
 - BIPOLAR : senza modulazione, micro, 100 W a 100 Ohms.

Completo di :

Placca neutra, manico porta elettrodi, set di elettrodi, pedale pneumatico


- 4. N° 5 APPARECCHI DI APALERT MISURATORE DI ATTI RESPIRATORI completo di raccordo girevole, sensori e dispositivo di controllo apnea (€ 280,00 circa) € 1.400,00
- 5. N° 5 ASTE PORTA FLEBO provvisto di n. 2 Gangi con cestello porta flebo in plastica € 285,00;

6. N° 5 microscopio binoculare completo di obiettivi 4x, 10x, 40x, 100x, oculare Wf 10X, diaframma as iride per il controllo di risoluzione e contrasto , carrello mobile (spostamento 7,6 x 5 cm) lettura graduata 0,1 mm per posizionamento preciso del vetrino, illuminazione alogena standard (12V/20W) €. **3.000,00;**
7. N°5 tosatrici Aesculap favorita II per piccoli animali , € **1.375,00;**
8. N°15 lame per Aesculapi favorita 2 mm1/20;Tot. € **745,50**
9. N° 8 termometri digitali € **41,28 ;**
10. N° 5 stetoscopi per piccoli animali 3M Littmann Classic II SE , 71 CM, alta sensibilità acustica, due cuffie, tubo unico, molla interna, Ø membrane 47 mm, Ø campana 36 mm € **550,00 ;**
11. N° 5 aspirapeli € **250,00;**
12. N° 5 forbici levapunti di spencer dritta cm.9 € **13,75;**
13. N° 25 forbici Mayo curva cm 15 € **121,75;**
14. N° 25 forbici Metzenbaum dritta cm 14,5 € **132,25;**
15. N° 25 forbici Metzenbaum curva cm 14,5 € **135,25;**
16. N° 25 pinze dissezione Adson cm 12 con denti € **68,00;**
17. N° 60 pinze Backhaus cm 9 € **271,20;**
18. N° 60 pinze Halsted Mosquito dritta 12,5 cm senza denti € **258,60;**
19. N° 60 pinze Halsted Mosquito curva 12,5 cm senza denti € **272,40;**
20. N° 20 pinze Allis con denti 4X5 di 15cm € **123,80;**
21. N° 20 pinze Rochester- Pean curva 16 cm clemmer € **174,80;**
22. N° 20 pinze Rochester- Pean dritta 16 cm clemmer € **174,80;**
23. N° 20 porta aghi Mayo- Hegard 15 cm AE € **560,00;**
24. N° 16 conf. Divaricatori di Farabeuf 15 cm (ogni confezione contiene n. 2 pezzi) € **122,08**


<i>Totale somma disponibile PON</i>	€ 73.630,00
<i>TOTALE attrezzature</i>	€ 53.372,46 (prezzi approssimativi senza IVA 22% € 11.741,9412) € 65.114,4012
<i>SOMMA RESIDUA EVENTUALE DISPONIBILE COMPENSIVA di IVA</i>	€ 8.515,5988 (totale lordo da calcolare iva)

Il Responsabile del Procedimento
(*Sig.ra Loreddana Li Causi*)

Il Direttore del Servizio
Ig. All. e pro. Zoot.
(*Dr. Antonio Izzo*)



[Home](#) [Chi siamo](#) [Carta dei Servizi](#) [Dipendenti](#) [URP](#) [Ufficio Stampa](#)

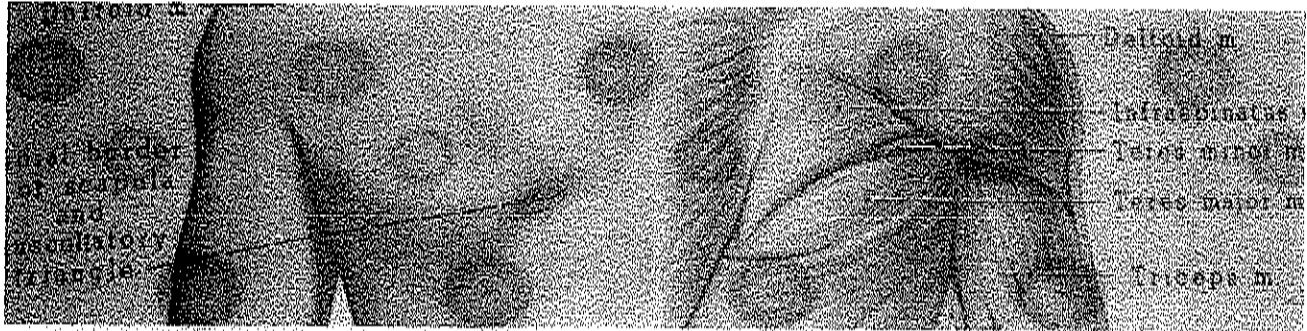

indagine di mercato di attrezzature varie per il Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

Publicato il 4 giugno 2019 dal settore EditorProvveditorato | Ultima modifica: 4 giugno 2019

Indagine di mercato di attrezzature varie per il Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

Scadenza presentazione preventivo entro il 10/06/2019

Allegati


[indagine di mercato di attrezzature varie per il Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche](#)

[Privacy](#) | [Note Legali](#) | [Elenco Siti tematici](#)

[Contatti](#)

[Pagine](#)

[Accesso](#)

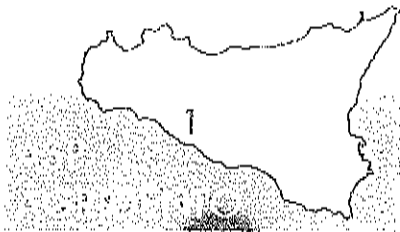

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento
Istruttore Dr. Giuseppe Sanfilippo Collaboratore Amm.vo esperto
Telefono 0922 407288 - 407145
FAX 0922 407119

Oggetto: Procedura negoziata tramite RDO/ME.PA. aperta per l'affidamento della fornitura di attrezzature, suddivisa in 7 lotti, occorrenti al Servizio Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell'ASP di Agrigento.
(Codice gara _____).

Il presente documento, denominato "Condizioni particolari di contratto", disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA, e precisamente "Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Beni e Capitolato tecnico relativo a "Forniture specifiche per la Sanità".

Questa Azienda indice, giusta Delibera a contrarre n. _____ del _____, esecutiva, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) e comma 6, del D.Lgs. 50/2016, e delle Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 n. 2 e n. 4 - procedura negoziata, tramite Richiesta di Offerta (RDO) sulla piattaforma ME.PA., per l'affidamento della fornitura di attrezzature, suddivisa in 7 lotti, occorrenti al Servizio Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell'ASP di Agrigento, per un importo complessivo presunto di € 50.703,83 = +IVA, con le specifiche tecniche di cui all'allegato capitolato tecnico, che riporta, per ciascun lotto, i codici CIG, le quantità presunte e gli importi a base d'asta.

Ogni lotto è unico ed indivisibile, e ciascun partecipante potrà concorrere per uno o più lotti.

Oggetto della presente fornitura è l'acquisto di attrezzature occorrenti al Servizio Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche di cui all'allegato capitolato tecnico, comprendente la consegna presso la struttura di interesse indicata nell'ordine.

In merito alla presenza dei rischi da interferenze ex art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si precisa che non è stato predisposto il D.U.V.R.I. perché la fornitura sarà eseguita in orari di chiusura e, comunque, senza la presenza di terzi. Pertanto non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza di cui all'art 26 D lgs 81/08 e s.m.i.

I beni da fornire, in possesso delle specifiche tecniche richieste, devono essere conformi alle normative di sicurezza CEE e dotati di marchio CE (Direttiva 93/42/CEE - D.Lgs. 46/97 ove necessario in relazione all'immissione in commercio, o conformità ad altra normativa vigente). I beni devono essere forniti completi di ogni accessorio tali da renderlo pienamente funzionante ed idoneo all'uso a cui è destinato.

In relazione alle specifiche tecniche dei beni oggetto delle presente procedura, trova applicazione quanto previsto dall'art.68 del D. Lgs. 50/2016, avente portata generale e, pertanto, si precisa che:

- l'offerente può discostarsi dalle specifiche tecniche, a condizione che la caratteristica proposta sia di livello equivalente o superiore a quella richiesta;
- qualora la descrizione dei prodotti richiesti dovesse casualmente individuare, anche con riferimento alle misure indicate, una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente";
- l'offerente può presentare un bene con caratteristiche tecniche non conformi alle specifiche richieste purché funzionalmente equivalente da un punto di vista clinico, con obbligo di segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica; nella propria offerta l'offerente è tenuto a dimostrare con qualunque mezzo appropriato che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

La ditta partecipante che intende proporre un bene con caratteristiche equivalenti deve produrre una dettagliata relazione tecnica, redatta sotto la forma di dichiarazione di responsabilità, da inserire nella busta B "Documentazione tecnica". La presunta equivalenza dovrà essere accertata dall'incaricato ad esprimere il giudizio di conformità tecnica, con riguardo alle finalità degli standard funzionali e prestazionali da garantire con l'utilizzo del dispositivo medico da acquisire, basandosi anche sull'eventuale campionatura del dispositivo offerto.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

La gara è aggiudicata ad un operatore economico, in possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, anche in presenza di una sola offerta valida, con il criterio del minor prezzo, previo giudizio positivo di conformità tecnica, in quanto trattasi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, ex art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016, come introdotto dal D.L. 32/2019, nella considerazione che le caratteristiche della prestazione da eseguire risultano definite negli atti di gara, con previsione di tutte le caratteristiche e condizioni di fornitura, restando in capo al concorrente solo l'offerta di un prezzo.

Ai sensi dell'art 97 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. L. 32/2019, l'Azienda procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter.

L'Azienda, inoltre, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, in applicazione dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 94 del D. Lgs. 50/2016. Non saranno ammesse le offerte con prezzo più alto rispetto al prezzo base sopra indicato, nonché le offerte di articoli con caratteristiche tecniche non conformi a quelle di cui alla presente procedura.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere chiarimenti sull'offerta presentata, assegnando un termine perentorio di presentazione alla Ditta offerente. Qualora ritenuto necessario visionare ed esaminare il bene offerto, al fine dell'emissione del giudizio di conformità tecnica, l'Amministrazione potrà richiedere alle ditte offerenti la presentazione della campionatura entro un termine perentorio indicato nella richiesta non inferiore a 10 giorni; la mancata presentazione della campionatura entro il termine comporterà l'esclusione dalla gara. La campionatura dovrà essere



accompagnata da dichiarazione di corrispondenza ai beni offerti. La mancata corrispondenza comporterà l'esclusione dalla procedura. Le spese di consegna e ritiro della campionatura sono a carico della ditta partecipante.

Unitamente all'offerta economica, ogni ditta invitata dovrà presentare la seguente documentazione:

1. dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante:
 - a. l'assunzione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
 - b. di accettare che le comunicazioni ex art. 76 D.Lgs. 50/2016 attinenti la presente procedura siano trasmesse tramite piattaforma ME.PA. e tramite pec indicando il relativo indirizzo;
 - c. di non trovarsi nei confronti della presente stazione appaltante nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
2. copia della presente debitamente firmata per accettazione;
3. breve relazione tecnica del bene offerto corredata di depliant illustrativi (se previsti), redatti in lingua italiana o tradotti in lingua italiana; nella relazione dovranno essere descritte in modo chiaro ed inconfutabile le caratteristiche tecniche del bene offerto, e quant'altro necessario alla valutazione tecnica del bene offerto; dovrà essere presentato un prospetto riepilogativo delle specifiche tecniche richieste nell'allegato capitolato tecnico con indicazione a fianco della presenza della caratteristica, con eventuale annessa descrizione di soluzione definita dall'offerente quale equivalente o migliorativa;
4. certificato CE (Direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici - possesso marcatura CE - o altra certificazione di conformità alla normativa vigente, in relazione all'oggetto di fornitura);
5. eventuale relazione tecnica, redatta sotto forma di dichiarazione di responsabilità, nell'ipotesi in cui la ditta partecipante intenda presentare un bene con caratteristiche equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche richieste nella presente procedura, corredata da dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla ditta produttrice.

In caso di omessa o incompleta presentazione degli elementi e delle dichiarazioni si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. È in ogni caso preclusa ogni possibilità di integrazione postuma dell'offerta tecnica ed economica. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Obblighi dell'aggiudicatario:

La ditta aggiudicataria dovrà:

- a) entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, costituire garanzia definitiva per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale e, comunque, secondo le modalità previste dall'art. 103 D.Lgs. 50/16: la garanzia, che ha la finalità di coprire gli oneri per il mancato



adempimento, dovrà avere validità per tutto il periodo di vigenza del contratto e sarà svincolata, previa richiesta scritta da parte della ditta interessata, soltanto alla cessazione del rapporto, sempreché la fornitura sia stata effettuata regolarmente e che non siano state sollevate dall'Azienda contestazioni, nella quale ipotesi sarà eventualmente restituita ad avvenuta definizione delle controversie. Sono richiamate qui le disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

- b) al momento della stipula del contratto telematico, provvedere al pagamento dell'imposta di bollo ex art. 2, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n.642 del 1972, e risoluzione 96/E del 16 dicembre 2013 dell'Agenzia Entrate.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA:

- 1) I beni da fornire devono essere nuovi di produzione e di ultima generazione, devono essere forniti nelle quantità, con le caratteristiche tecniche e nella configurazione offerta, valutata conforme dai soggetti appositamente incaricati dall'Amministrazione;
- 2) la fornitura è in regime di somministrazione e, pertanto, si conviene, ai sensi dell'art. 1560 del codice civile, che le quantità sopra indicate per ciascuna voce sono meramente orientative potendo variare in più o in meno in relazione al mutato fabbisogno, sulla base delle effettive esigenze delle UU.OO. dell'Azienda, per cui la quantità non è determinata, ma si intende pattuita quella corrispondente al reale fabbisogno dell'Azienda nel periodo di vigenza contrattuale. Pertanto, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che saranno effettivamente ordinate dalla Direzione di Farmacia del P.O., senza poter avanzare alcuna pretesa o reclamo in ordine alle quantità ordinate. Gli ordini verranno emessi dalla Direzione di Farmacia di volta in volta, secondo le effettive necessità dell'Azienda. Inoltre l'ASP non è obbligata ad acquistare i prodotti in gara se non ritenuti più necessari alla propria attività;
- 3) Il prezzo complessivo del presente appalto è dato dal prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria; il prezzo offerto comprende l'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal presente capitolato; la merce dovrà essere consegnata presso la sede indicata nell'ordine entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni di calendario dalla data dell'ordine, che sarà trasmesso tramite piattaforma o tramite mail o fax; in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, potrà applicare a carico del fornitore una penale nella misura come determinata nelle "Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Beni e Capitolato tecnico relativo a "Forniture specifiche per la Sanità";
- 4) La fornitura, in conformità all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, sarà sottoposta a verifica di conformità, per accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle prescrizioni contrattuali, fatte salve le eventuali leggi di settore. Le operazioni di verifica avranno inizio successivamente all'emissione da parte del DEC del certificato di ultimazione delle prestazioni, la quale emissione potrà avvenire su specifica comunicazione della ditta fornitrice. La verifica di conformità avverrà alla presenza del/i soggetto/i incaricato/i dall'ASP di detta verifica, dei tecnici della ditta fornitrice e del DEC (se la verifica è effettuata da soggetto diverso dal DEC). Al fine della verifica di conformità costituirà elemento di riferimento ogni dichiarazione effettuata in sede di offerta. L'esito positivo della verifica di conformità e l'emissione del relativo certificato controfirmato da entrambe le

parti, saranno imprescindibili ai fini del successivo pagamento. All'esito positivo della verifica di conformità, la ditta procederà all'emissione della fattura. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese della ditta fornitrice; nell'eventualità di discordanze qualitative, questa Azienda respingerà la merce che dovrà essere sostituita immediatamente con altra pienamente rispondente alle caratteristiche di cui al capitolato tecnico ed alle caratteristiche dichiarate dalla ditta aggiudicataria in sede di gara. La sostituzione dovrà avvenire entro breve termine fissato ad insindacabile giudizio dell'Azienda, riservandosi di applicare, inoltre, la penale sopra prevista e di procedere alla risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la possibilità di acquistare presso la ditta seconda classificata, o in mancanza sul libero mercato, addebitando le maggiori spese al fornitore inadempiente. Il collaudo, oltre ad accertare che l'apparecchiatura e le attrezzature connesse sono state regolarmente installate e sono regolarmente funzionanti, dovrà attestare che le stesse sono rispondenti alle normative di sicurezza in vigore (specificando quali) anche ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento della fattura. La merce non accettata resta a disposizione del fornitore ed a suo rischio e pericolo, egli dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna sia per il ritiro della stessa merce.

- 5) La copertura finanziaria della presente fornitura è assicurata con Fondi PON - PSN 2016/17, Linea Progettuale 4 - Azione 4.2.10; la fattura sarà liquidata entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della medesima fattura, previa attestazione di merce fornita, attestata dalla Farmacia ordinante, in conformità al D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012; la fattura dovrà fare esplicito riferimento al provvedimento di affidamento, al corrispondente ordine informatico emesso da questa Azienda ed al corrispondente documento di trasporto. In caso di difformità tra prezzo contrattuale indicato nell'ordine e prezzo in fattura, l'ASP richiederà nota di credito alla ditta fornitrice con interruzione dei termini di pagamento. In caso di contestazioni il pagamento della fattura in corso di liquidazione sarà sospeso fino alla definizione delle stesse; nell'ipotesi in cui non venisse rispettato il termine di pagamento sopra indicato, sarà applicato quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012;
- 6) In caso di cessione del credito, trova applicazione quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016; l'Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica della cessione di credito; resta inteso che l'ASP ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto; una volta notificato l'atto di cessione, il creditore non può opporre in compensazione il credito ceduto.
- 7) La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 8 del Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana", si impegna, pena il recesso del contratto, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);



- 8) La ditta aggiudicataria si impegna, pena la nullità assoluta del contratto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
- 9) La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare, durante la vigenza del rapporto contrattuale, ogni eventuale ipotesi in cui il proprio legale rappresentante o uno dei propri dirigenti siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
- 10) Per tutte le controversie, che dovessero eventualmente sorgere, sarà competente esclusivamente il Foro di Agrigento.

La presente non vincola quest'Azienda, in quanto il vincolo sorgerà solo dopo l'esecutività del provvedimento di affidamento della fornitura, e la sottoscrizione del relativo contratto per mezzo di scambio di corrispondenza tramite piattaforma. Successivamente alla stipula sarà emesso ordine con procedura informatica in uso all'ASP contenente le informazioni necessarie alla corretta fatturazione elettronica.

Per maggiori informazioni contattare il Servizio Provveditorato (tel. 0922/407268/407145 – fax 0922 407119).

Il Direttore Servizio Provveditorato
Dr.ssa Loredana Di Salvo



PER ESPRESSA ACCETTAZIONE
EX ARTT. 1341 E 1342 CODICE CIVILE
LA DITTA
(timbro e firma del legale rappresentante)



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Sede legale : Viale della Vittoria n. 321 - 92100 Agrigento

Partita IVA - Codice Fiscale : 02570930848

RDO N.

CAPITOLATO TECNICO

LOTTO N. 1 IMPORTO A BASE D'ASTA € 8.075,00

N° 5 autoclavi per la sterilizzazione di ferri chirurgici;

caratteristiche tecniche:

- a) (Vtaggio (V) Freq. (Hz) 220/240V, 50/60 Hz;10A
- b) Dimensione della camera: 17 x 32 cm
- c) Fusibili principali: F16A/400V
- d) Potenza nominale: 1500W
- e) Temperatura di sterilizzazione: 121 °C / 134 °C
- f) Capacità serbatoio acqua distillata: 2,5 litri approx.
- g) Temperatura ambientale funzionamento: 5 - 40 °C
- h) Dimensioni esterne: 414 x 365 x 530 mm
- i) Peso netto dell'Autoclave: 34,5 Kg
- j) Livello potenza sonora :<70 dB
- k) Umidità relativa ambiente di funzionamento: 80% massimo
- l) Pressione atmosferica: 76kPa - 106kPa).

LOTTO N. 2 IMPORTO A BASE D'ASTA € 28.500,00

N° 5 apparecchi per esame emocromo completo

caratteristiche tecniche:

- a) **Analizzatore per ematologia BC-2800Vet** Mindray Analizzatore automatico per ematologia compatto con conta differenziata di WBC per cani e gatti. 19 parametri + 3 istogrammi per cane, gatto, cavallo, topo, ratto e coniglio. 12 parametri + 3 istogrammi per suino, bovino, bufalo, pecora, capra e cammello.
- b) Possibilità di archiviare fino a 10.000 risultati analisi.
- c) Predisposizione per 12 banche dati (cane, gatto, cavallo, topo, ratto, coniglio, suino, bovino, bufalo, capra, pecora e cammello) + 4 programmabili a richiesta.
- d) Sistema di pulizia automatico della sonda aspiratrice .
- e) Sistema di pulizia interno ed esterno automatico.
- f) Reagenti senza cianide per evitare contaminazioni nell'ambiente.
- g) Sistema di calcolo indipendente per ogni specie animale per assicurare l'alta precisione.
- h) Programma di calibrazione interamente automatico.
- i) Caratteristiche tecniche : - Parametri : WBC, RBC, HGB, MCV, MCH, MCHC, RDW, HTC, PTL, MPV, PDW, PCT. Ulteriori parametri per cane, gatto, cavallo, topo, ratto e coniglio
- j) Istogramma per WBC, RBC, PTL - Principi di analisi : impedenza elettrica per il calcolo dei parametri e metodo SFT per l'emoglobina - Volume del campione : diluito 20uL, puro 13uL - Capacità lavorativa : 25 campioni analizzati per ora - Schermo TFT 7,5" a colori, visualizza tutti i parametri e gli istogrammi. Risoluzione: 640 x 480 - Menu : Calcolo, Visualizzazione Dati, Controllo Qualità, Impostazioni, Servizi, Calibrazione, Spegnimento - Stampante termica interna ed esterna (opzionale), collegamento tastiera - Software per PC semplice da usare - Alimentazione : AC 220V + 15, 50/60 + 1 Hz o AC 110V + 15, 50/60 + 1 Hz - Dimensioni : 437 mm (h) x 322 mm (p) x 386 mm (l) - Peso 17,9 kg;

LOTTO N. 3 IMPORTO A BASE D'ASTA € 4.560,00

N° 5 elettrobisturi con accessori (completo di manipolare) per chirurgia monopolare; ;

Caratteristiche tecniche:

Elettrobisturi SU 140-MPC

- Elettrobisturi a tecnologia digitale con microprocessore di controllo. L'MPC System è un sofisticato sistema di controllo dei parametri di funzionamento, che garantisce prestazioni e sicurezza altrimenti inottenibili. Il sistema è dotato di una completa autodiagnosi all'accensione e di un controllo in tempo reale durante l'uso, in effetti il funzionamento viene bloccato automaticamente in caso di guasti. Le potenze erogate sono controllate mediante microprocessore, ADC System e bloccate in caso di guasti, impedendo una potenziale erogazione di potenza superiore a quella selezionata.

Il sistema controlla anche le correnti di dispersione A.F. verificando eventuali disadattamenti dell'impedenza e riducendo automaticamente la tensione d'uscita a livelli di sicurezza.

Segnali acustici e luminosi :

- taglio (suono grave, luce gialla)
 - coagulazione (suono acuto, luce blu)
- Dotato di 5 correnti con impulso iniziale controllato elettronicamente per ottenere migliori con l'utilizzo di potenze più basse :
- CUT : senza modulazione, per taglio puro senza emostasi, 140 W a 500 Ohms
 - BLEND : combinazione modulata di corrente da taglio ed emostasi per taglio coagulante, 120 W a 500 Ohms
 - COAG : ad alto voltaggio, per coagulazione anche senza contatto e con forte effetto superficiale, 120 W a 500 Ohms
 - MICRO : a basso voltaggio, 60 W a 200 Ohms
 - BIPOLAR : senza modulazione, micro, 100 W a 100 Ohms.

Completo di :

Placca neutra, manico porta elettrodi, set di elettrodi, pedale pneumatico

LOTTO N. 4 IMPORTO A BASE D'ASTA € 1.330,00

N° 5 APPARECCHI DI APALERT MISURATORE DI ATTI RESPIRATORI completi di raccordo girevole, sensori e dispositivo di controllo apnea.

LOTTO N. 5 IMPORTO A BASE D'ASTA € 2.850,00

N° 5 microscopio binoculare completo di obiettivi 4x, 10x, 40x, 100x, oculare Wf 10X, diaphragma as iride per il controllo di risoluzione e contrasto , carrello mobile (spostamento 7,6 x 5 cm) lettura graduata 0,1 mm per posizionamento preciso del vetrino, illuminazione alogena standard (12V/20W).

LOTTO N. 6 IMPORTO A BASE D'ASTA € 2.251,97

N°5 tosatrici Aesculap favorita II per piccoli animali.

N°15 lame per Aesculapi favorita 2 mm1/20.

N° 5 aspirapeli.

LOTTO N. 7 IMPORTO A BASE D'ASTA € 3.136,86

Voce a)

N° 5 ASTE PORTA FLEBO provviste di n. 2 gangi con cestello porta flebo in plastica.

Voce b)

N° 8 termometri digitali.

Voce c)

N° 5 stetoscopi per piccoli animali 3M Littmann Classic II SE , 71 CM, alta sensibilità acustica, due cuffie, tubo unico, molla interna, Ø membrane 47 mm, Ø campana 36 mm.

Voce d)

N° 5 forbici levapunti di spencer dritta cm. 9.

Voce e)

N° 25 forbici Mayo curva cm 15.

Voce f)

N° 25 forbici Metzenbaum dritta cm 14,5.

Voce g)

N° 25 forbici Metzenbaum curva cm 14,5.

Voce j)

N° 25 pinze dissezione Adson cm 12 con denti.

Voce k)

N° 60 pinze Backhaus cm 9.

Voce l)

N° 60 pinze Halsted Mosquito dritta 12,5 cm senza denti.

Voce m)

N° 60 pinze Halsted Mosquito curva 12,5 cm senza denti.

Voce n)

N° 20 pinze Allis con denti 4X5 di 15cm.

Voce o)

N° 20 pinze Rochester- Pean curva 16 cm clemmer.

Voce p)


N° 20 pinze Rochester- Pean dritta 16 cm clemmer.

Voce q)

N° 20 porta aghi Mayo- Hegard 15 cm AE.

Voce r)

N° 16 conf. Divaricatori di Farabeuf 15 cm (ogni confezione contiene n. 2 pezzi).

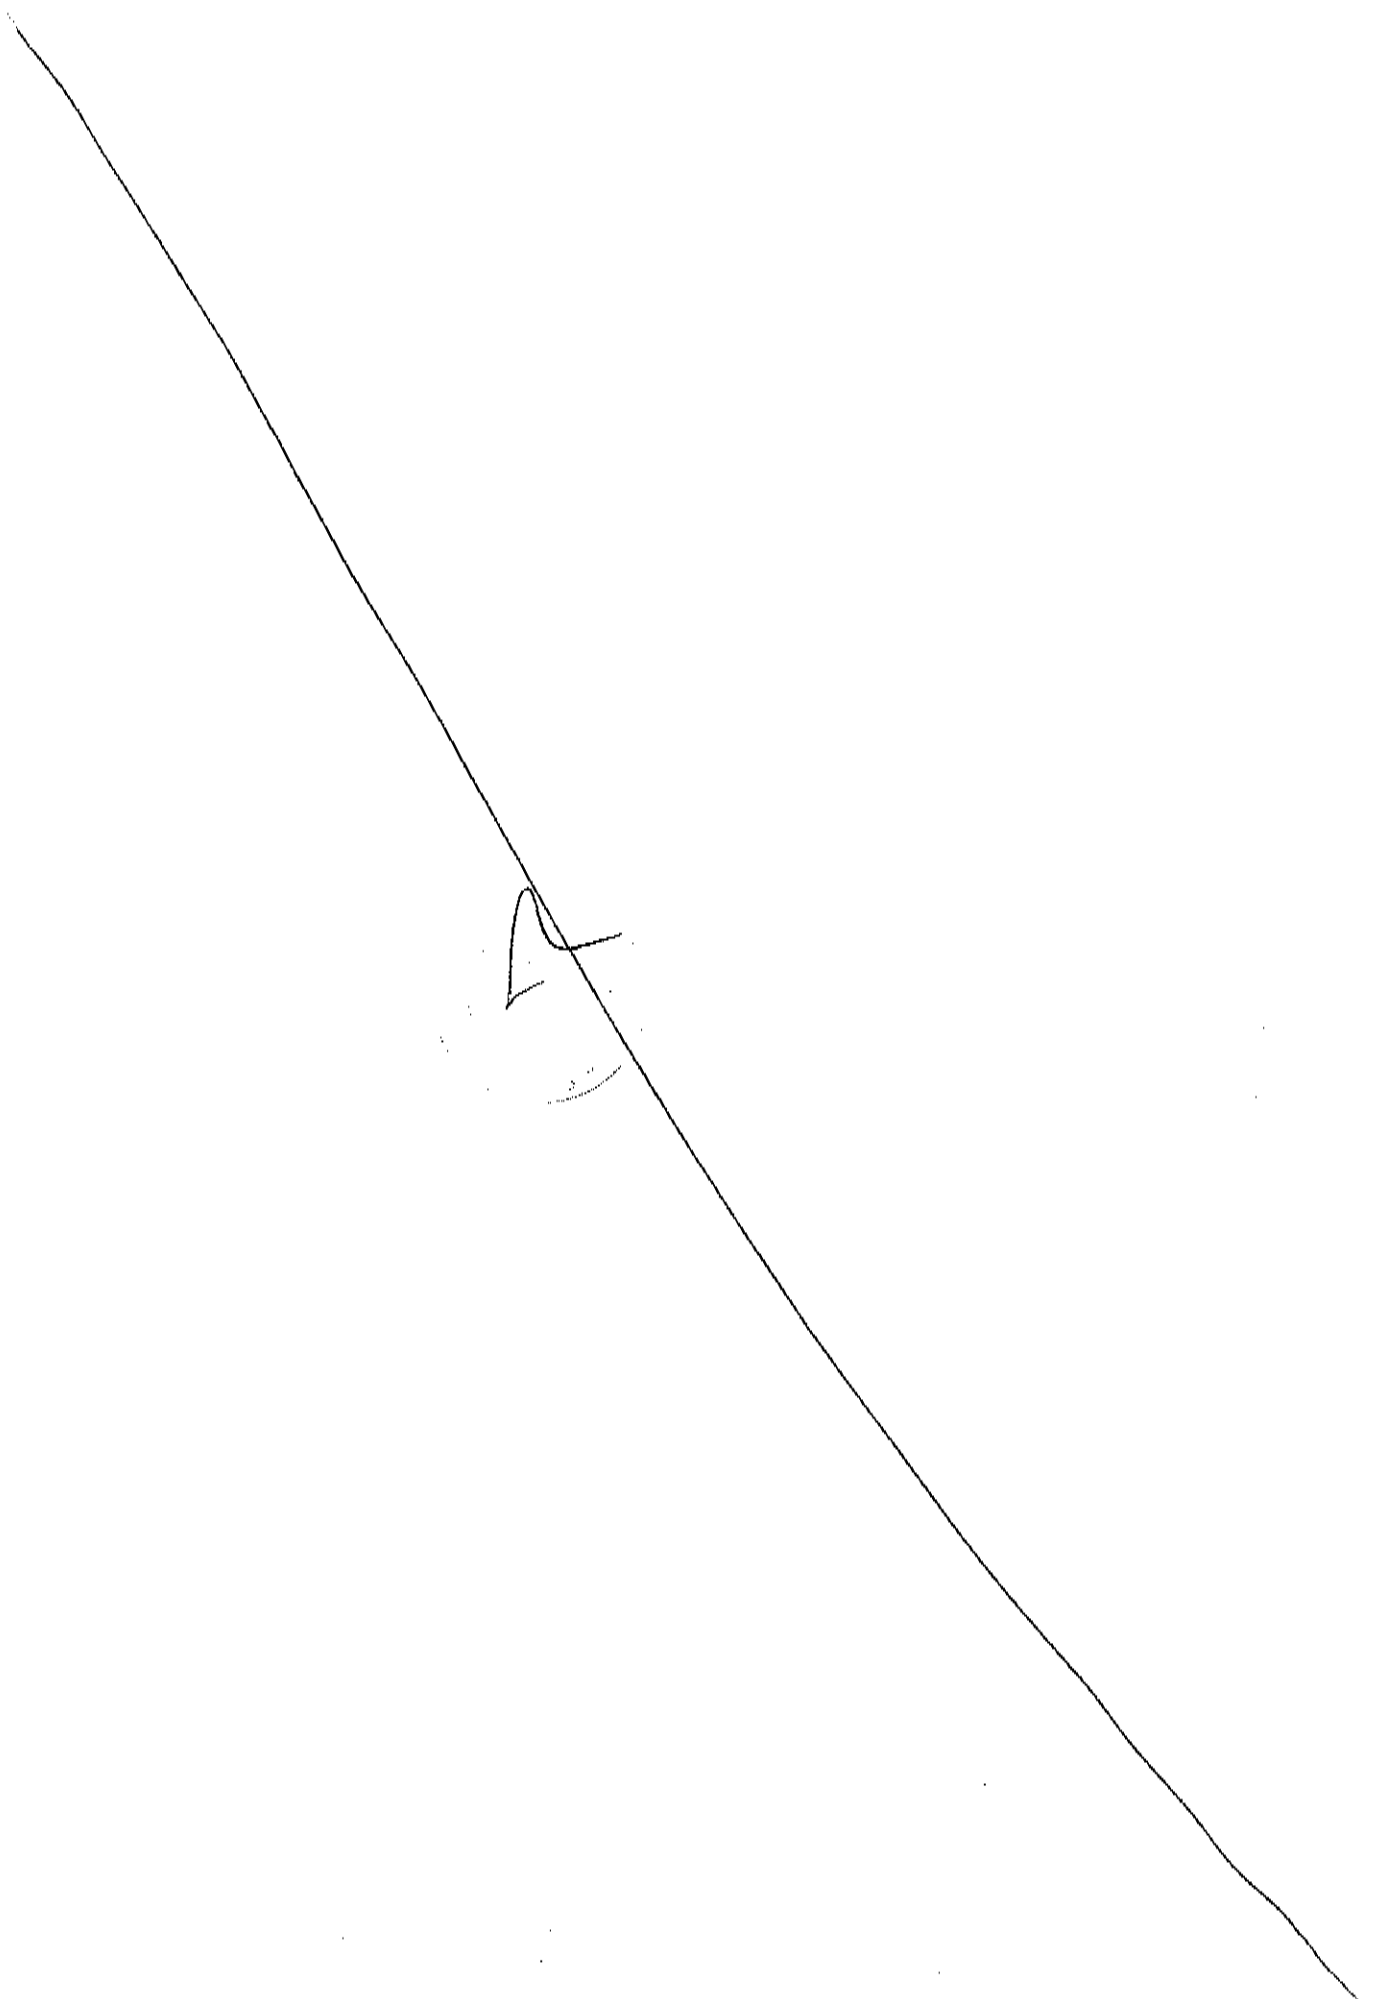

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Titolare di Posizione Organizzativa
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma
Dott.ssa Patrizia Tedesco

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

Immediatamente esecutiva dal **27 GIU. 2019**

Agrigento, li **27 GIU. 2019**

Il Titolare di Posizione Organizzativa
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma
Dott.ssa Patrizia Tedesco

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

1. Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
2. Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Titolare di Posizione Organizzativa
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma
Dott.ssa Patrizia Tedesco