

Verbale n. 1

**REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO**

Procedura negoziata tramite RDO/ME.PA. n. 2769050 per la fornitura in acquisto di n. 8 ventilatori polmonari per il reparto di terapia intensiva del P.O. di Agrigento.

VERBALE DI GARA

L'anno duemilaventuno il giorno 25 del mese di Marzo in Agrigento, alle ore 11,00 circa presso gli uffici amministrativi dell'U.O.C. Servizio Provveditorato dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, sita in Agrigento – Viale Della Vittoria, in seduta pubblica, sono presenti i Sigg.:

- Dr.ssa Rosalia Calà – Presidente - Dirigente Amministrativo – Servizio Provveditorato ASP Agrigento;
- Sig. Alfonso De Leo – Segretario – Assistente Amministrativo - Servizio Provveditorato ASP Agrigento
- Sig. Giovanni Di Nolfo – Testimone – Coadiutore Amministrativo - Servizio Provveditorato ASP Agrigento;

i quali in data odierna intervengono al presente atto in qualità di componenti il seggio di gara, per la verifica della documentazione amministrativa per l'affidamento della fornitura in acquisto di n. 8 ventilatori polmonari per il reparto di terapia intensiva del P.O. di Agrigento, con l'assistenza del Segretario verbalizzante Sig.ra Daniela Parla – Operatore Tecnico – del Servizio Provveditorato ASP Agrigento.

PREMESSO CHE

- con deliberazione n. 386 dell' 11/03/2021 è stata indetta Procedura di gara tramite RDO/MEPA, ai sensi dell'art. 63 c. 2 lett. C) del D. Lgs. N. 50/16 e s.m.i., avendo già esperito preliminarmente consultazione di mercato come previsto dal predetto articolo al comma 6, per l'affidamento della fornitura in parola, mediante il criterio di cui all'art. 95 c. 2, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i. e cioè a favore del prezzo più basso;
- con la suindicata Delibera è stato approvato la lettera d'invito/capitolato speciale e la scheda tecnica contenente le caratteristiche di minima dei ventilatori polmonari di cui all'oggetto, per l'ammissione alla gara e la presentazione dell'offerta;
- la presente gara si articola in un unico lotto con Codice di Gara 8088474 e CIG 8676485DEA;
- in data 19/03/2021 è stata pubblicata nella piattaforma la RDO ME.PA. n. 2769050 per la fornitura de qua;
- il termine di scadenza è stato fissato per le ore 10:00 del 25/09/2021, quale termine ultimo per la presentazione delle offerte;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
SI ESPONE QUANTO SEGUE**

La Dr.ssa Rosalia Calà, operando attraverso il sistema ME.PA., dichiara aperta la seduta pubblica di gara,

dopo aver verificato che alla stessa non sono presenti i rappresentanti degli eventuali operatori economici partecipanti, i quali possono, comunque, verificare da remoto le operazioni effettuate sulla piattaforma. Vengono riassunti i termini della gara e l'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta al prezzo più basso (art. 95 c. 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 63/06 e s.m.i.) previo giudizio di conformità tecnica.

Il Presidente dà atto che tramite piattaforma telematica sono pervenuti i plichi inviati, sempre tramite sistema, dai seguenti operatori economici:

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
1	3C MED S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	24/03/2021 11:15:51
2	BETAFIN	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	24/03/2021 21:02:04
3	BURKE & BURKE	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	23/03/2021 17:01:05
4	GETINGE ITALIA SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	23/03/2021 09:22:19
5	MEDIGAS ITALIA SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	24/03/2021 16:44:09
6	ULTRAMED S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	23/03/2021 12:41:56

Il Presidente procede alla verifica della ricezione delle offerte presentate e le stesse sono composte da: *Documentazione amministrativa, Documentazione tecnica e Offerta economica.*

Successivamente si procede attraverso il Sistema ad accedere all'area contenente la "Documentazione amministrativa" di ciascuna singola offerta presentata, mentre, le *Offerte tecniche* e, le *Offerte economiche* resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non è visibile né all'Ufficio, né al seggio di gara, né all'ASP di Agrigento né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; il Sistema consente l'accesso alla *Documentazione amministrativa* e il presente seggio di gara deputato all'esame della stessa procede alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti, quindi all'apertura della documentazione amministrativa, per come ordinata dal Sistema, relativamente ad ogni singolo partecipante.

Premesso quanto sopra, si riscontra quanto segue:

#	Denominazione concorrente	Lotti a cui ha partecipato	AMMESSA
1	3C MED S.R.L.	Lotto 1	AMMESSA CON RISERVA
2	BETAFIN	Lotto 1	AMMESSA
3	BURKE & BURKE	Lotto 1	AMMESSA CON RISERVA
4	GETINGE ITALIA SRL	Lotto 1	AMMESSA
5	MEDIGAS ITALIA SRL	Lotto 1	AMMESSA CON RISERVA
6	ULTRAMED S.R.L.	Lotto 1	AMMESSA

1) 3C MED S.R.L.:

La documentazione amministrativa, contenuta nella relativa area di sistema, è presente, ma viene attivato soccorso istruttorio atteso che l'operatore economico non ha presentato il versamento del contributo ANAC dovuto e pari ad € 20,00;

2) BURKE & BURKE:

La documentazione amministrativa, contenuta nella relativa area di sistema, è presente, ma viene attivato soccorso istruttorio atteso che l'operatore economico non ha presentato il versamento del contributo ANAC dovuto e pari ad € 20,00;

3) MEDIGAS ITALIA SRL:

La documentazione amministrativa, contenuta nella relativa area di sistema, è presente, ma viene attivato soccorso istruttorio atteso che l'operatore economico non ha presentato il versamento del contributo ANAC dovuto e pari ad € 20,00;

Il seggio di gara fa presente che si procede ad attivare soccorso istruttorio per i sopra citati operatori economici, in quanto questa Stazione Appaltante, per mero errore, non ha inserito tra le prescrizioni di gara che gli operatori economici dovevano presentare ricevuta di pagamento del contributo ANAC pari ad € 20,00 per l'ammissione alla gara.


Il seggio di gara, attesa l'urgenza di proseguire l'iter di gara, - in quanto le apparecchiature di che trattasi necessitano a fronteggiare l'emergenza pandemica COVID-19 -, procede all'apertura anche delle buste tecniche degli operatori economici cui è stato attivato il soccorso istruttorio, trasmettendo le medesime offerte per la relativa valutazione al Responsabile dell'U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Agrigento per il relativo esame tecnico rispetto alle prescrizioni tecniche di minima di gara.

Il presente verbale viene notificato, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs.vo 50/2016 a tutti gli operatori partecipanti alla RDO in parola tramite piattaforma www.acquistinretepa.it sezione RDO ME.PA., comunicando sin da ora agli operatori economici ammessi con riserva che verranno esclusi dal prosieguo di gara, anche se valutati conformi tecnicamente dal Responsabile di cui sopra, se non ottemperano al soccorso istruttorio attivato per le motivazioni sopra riportate, entro gg. 7 (sette) dalla data odierna che corrisponde alla data di notifica a mezzo ME.PA., ovvero entro le ore 12:00 del giorno 01/04/2021.

Il presente verbale, che consta di tre pagine, viene letto e sottoscritto alle ore 15,40 per come segue:

IL SEGGIO DI GARA

- Dr.ssa Rosalia Calà



- Sig.ra Daniela Parla


 Segretario

I TESTIMONI

- Sig. Alfonso De Leo



- Sig. Giovanni Di Nolfo



DETTAGLIO MESSAGGIO INVIATO

Mittente	ORESTE FALCO - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
Oggetto	Notifica ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs.vo 50/2016 e attivazione soccorso istruttorio. - 2769050 - GARA TELEMATICA MEPA PER ACQUISTO DI 8 VENTILATORI POLMONARI PER IL REPARTO DI TERAPIA INTENSIVA DEL PO DI AGRIGENTO
Destinatari	11 - Destinatari
Id iniziativa	2769050
Nome Iniziativa	GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI 8 VENTILATORI POLMONARI PER IL REPARTO DI TERAPIA INTENSIVA AGRIGENTO
Nome Amministrazione	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
Nome e cognome PO	ORESTE FALCO
Data ultima per la presentazione delle Offerte	25/03/2021 10:00
Contenuto	Si notifica il verbale della seduta di gara del 25.03.2021 con attivazione del soccorso istruttorio per i seguenti operatori economici: & BURKE - MEDIGAS ITALIA S.R.L..
Allegati	-
Importo di consegna del messaggio	

Rapporto di consegna

Destinatario	Data di invio	Data di consegna	Data di prelievo	Data di lettura
VYAIR SRL	25/03/2021 15:54	25/03/2021 15:54		
FORMEDICAL CO. SRL	25/03/2021 15:54	25/03/2021 15:54		
ULTRAMED S.R.L.	25/03/2021 15:54	25/03/2021 15:54		
BURKE & BURKE	25/03/2021 15:54	25/03/2021 15:54		
DRAEGER ITALIA	25/03/2021 15:54	25/03/2021 15:54		
MEDTRONIC ITALIA	25/03/2021 15:54	25/03/2021 15:54		
BETAFIN	25/03/2021 15:54	25/03/2021 15:54		
GETINGE ITALIA SRL	25/03/2021 15:54	25/03/2021 15:54		
3C MED S.R.L.	25/03/2021 15:54	25/03/2021 15:54		
GIMAS SRL	25/03/2021 15:54	25/03/2021 15:54		
MEDIGAS ITALIA SRL	25/03/2021 15:54	25/03/2021 15:54		

Verbale n. 2

**REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO**

Procedura negoziata tramite RDO/ME.PA. n. 2769050 per la fornitura in acquisto di n. 8 ventilatori polmonari per il reparto di terapia intensiva del P.O. di Agrigento.

VERBALE DI GARA

L'anno duemilaventuno il giorno 1 del mese di Aprile in Agrigento, alle ore 11,00 circa presso gli uffici amministrativi dell'U.O.C. Servizio Provveditorato dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, sita in Agrigento – Viale Della Vittoria, in seduta pubblica, sono presenti i Sigg.:

- Dr.ssa Rosalia Calà – Presidente - Dirigente Amministrativo – Servizio Provveditorato ASP Agrigento;
- Sig.ra Cristina Bellavia – Testimone – Operatore Tecnico - Servizio Provveditorato ASP Agrigento;
- Sig. Giovanni Di Nolfo – Testimone – Coadiutore Amministrativo - Servizio Provveditorato ASP Agrigento;

i quali in data odierna intervengono al presente atto in qualità di componenti il seggio di gara, per la verifica della documentazione amministrativa per l'affidamento della fornitura in acquisto di n. 8 ventilatori polmonari per il reparto di terapia intensiva del P.O. di Agrigento, con l'assistenza del Segretario verbalizzante Dr. Giuseppe Sanfilippo – Collaboratore Amministrativo Esperto TPO – del Servizio Provveditorato ASP Agrigento.

PREMESSO CHE

- con deliberazione n. 386 dell' 11/03/2021 è stata indetta Procedura di gara tramite RDO/MEPA, ai sensi dell'art. 63 c. 2 lett. C) del D. Lgs. N. 50/16 e s.m.i., avendo già esperito preliminarmente consultazione di mercato come previsto dal predetto articolo al comma 6, per l'affidamento della fornitura in parola, mediante il criterio di cui all'art. 95 c. 2, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i. e cioè a favore del prezzo più basso;
- con la suindicata Delibera è stato approvato la lettera d'invito/capitolato speciale e la scheda tecnica contenente le caratteristiche di minima dei ventilatori polmonari di cui all'oggetto, per l'ammissione alla gara e la presentazione dell'offerta;
- la presente gara si articola in un unico lotto con Codice di Gara 8088474 e CIG 8676485DEA;
- in data 19/03/2021 è stata pubblicata nella piattaforma la RDO ME.PA. n. 2769050 per la fornitura de qua;
- il termine di scadenza è stato fissato per le ore 10:00 del 25/09/2021, quale termine ultimo per la presentazione delle offerte;
- sono pervenute entro la predetta scadenza tramite piattaforma www.acquistinretepa.it le seguenti offerte:

Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
---------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------------------

[Handwritten signatures and initials]

Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
3C MED S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	24/03/2021 11:15:51
BETAFIN	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	24/03/2021 21:02:04
BURKE & BURKE	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	23/03/2021 17:01:05
GETINGE ITALIA SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	23/03/2021 09:22:19
MEDIGAS ITALIA SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	24/03/2021 16:44:09
ULTRAMED S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	23/03/2021 12:41:56

Con verbale del 25 Marzo u.s. il seggio di gara ha svolto i seguenti lavori:

- ha esaminato la documentazione amministrativa delle ditte partecipanti;
- ha ammesso alla fase successiva gli operatori economici BETAFIN, GETINGE ITALIA SRL e ULTRAMED S.R.L., ivi onerando gli operatori economici 3C MED S.R.L., BURKE & BURKE e MEDIGAS ITALIA SRL, in quanto per quest'ultimi è stato attivato soccorso istruttorio atteso che i medesimi operatori economici non hanno presentato il versamento del contributo ANAC dovuto e pari ad € 20,00, contributo per mero errore non indicato tra le clausole di esclusione negli atti di gara ovvero lettera d'invito/capitolato speciale predisposti da questa Stazione Appaltante;
- ha proceduto, attesa l'urgenza di proseguire l'iter di gara, - in quanto le apparecchiature di che trattasi necessitano a fronteggiare l'emergenza pandemica COVID-19 -, all'apertura anche delle buste tecniche degli operatori economici cui è stato attivato il soccorso istruttorio, trasmettendo le medesime offerte per la relativa valutazione al Responsabile dell'U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Agrigento per il relativo esame tecnico rispetto alle prescrizioni tecniche di minima di gara.

Con email del 25.03.2021 sono state inviate al Responsabile f.f. del Complesso Operatorio del P.O. di Agrigento le offerte tecniche di tutti gli operatori economici partecipanti alla gara compreso quelli ammessi con riserva;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
SI ESPONE QUANTO SEGUE**

Il seggio di gara, operando attraverso il sistema ME.PA., dichiara aperta la seduta pubblica di gara, dopo aver verificato che alla stessa non sono presenti i rappresentanti degli eventuali operatori economici partecipanti, i quali possono, comunque, verificare da remoto le operazioni effettuate sulla piattaforma.

Il seggio di gara preso atto della regolarizzazione della documentazione pervenuta dagli operatori economici di cui sopra, avvenuta entro i termini assegnati, scioglie la riserva a carico degli stessi e li ammette al prosieguo di gara.

Be




Il Presidente comunica che con nota prot. n. 57754 del 30.03.2021 il Responsabile f.f. del Complesso Operatorio ha trasmesso il giudizio tecnico di conformità dandone lettura e riportandone gli esiti nella sottostante tabella:

OPERATORI ECONOMICI AMMESSI	GIUDIZIO DI CONFORMITA'
3C MED S.R.L.	NON CONFORME
BETAFIN	NON CONFORME
BURKE & BURKE	CONFORME
GETINGE ITALIA SRL	CONFORME
MEDIGAS ITALIA SRL	NON CONFORME
ULTRAMED S.R.L.	CONFORME

Per le offerte non conformi le motivazioni tecniche espresse dal Responsabile f.f. del Complesso Operatorio del P.O. di Agrigento sono riportate analiticamente nella nota prot. n. 57754 del 30.03.2021, relazione che si allega al presente atto facendone parte integrante.

tutto ciò premesso la Commissione di gara

Procede all'apertura dei files contenenti le offerte economiche relative agli operatori economici che sono risultati conformi e ammessi al prosieguo di gara.

Dal contenuto degli stessi ne viene data pubblica lettura riportandone gli esiti qui di seguito:

BURKE & BURKE	€ 174.400,00
GETINGE ITALIA SRL	€ 198.400,00
ULTRAMED S.R.L.	€ 135.120,00

La commissione di gara aggiudica provvisoriamente la fornitura del lotto per come segue:


LOTTO CIG 8676485DEA:

ULTRAMED S.R.L.	€ 135.120,00
-----------------	--------------


Il presente verbale viene notificato, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs.vo 50/2016 a tutti gli operatori partecipanti alla RDO in parola tramite piattaforma www.acquistinretepa.it sezione RDO ME.PA.. Il presente verbale, che consta di tre pagine, viene letto e sottoscritto alle ore 11,35 per come segue:

IL SEGGIO DI GARA

- Dr.ssa Rosalia Calà




- Dr. Giuseppe Sanfilippo

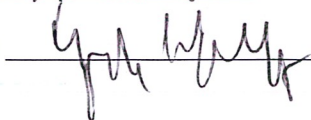


Segretario

I TESTIMONI

- Sig.ra Cristina Bellavia



- Sig. Giovanni Di Nolfo





Prot. N. 00 57754 del 30/03/2021

Al Direttore UOC Provveditorato
Dr. O. Falco

Oggetto: relazione di conformità dopo valutazione schede tecniche relative alla RDO ME.PA. 2769050 per la fornitura di n. 8 ventilatori polmonari per la Terapia Intensiva del P.O. di Agrigento.

Gent.mo

Avendo ricevuto mezzo email le schede tecniche relative ai ventilatori polmonari da Terapia Intensiva da destinare alla Rianimazione del P.O. di Agrigento, dopo attenta analisi di quanto descritto dalle Ditte partecipanti, si invia relazione descrittiva con relativo parere di conformità o non conformità:

DITTE e PRODOTTI CONFORMI:

Ditta Ultramed. Prodotto offerto: GE Carecape R860

Il prodotto offerto risulta **conforme** a tutti i requisiti minimi richiesti dal Capitolato Tecnico di gara.

Ditta Burke & Burke. Prodotto offerto: Hamilton G5

Il prodotto offerto risulta **conforme** a tutti i requisiti minimi richiesti dal Capitolato Tecnico di gara.

Ditta GETINGE. Prodotto offerto: GETINGE Servo U

Il prodotto offerto risulta **conforme** a tutti i requisiti minimi richiesti dal Capitolato Tecnico di gara.

DITTE e PRODOTTI NON CONFORMI:

Ditta 3C MED. Prodotto offerto: Mindray SV600

Il prodotto offerto presenta le seguenti non conformità:

- Il Capitolato Tecnico, al punto 41, richiede:

“Sistema per la nebulizzazione di farmaci integrato collegabile alla Y del circuito tramite apposito adattatore, controllabile tramite il display del ventilatore per nebulizzazione continua, utilizzabile su pazienti adulti e pediatrici senza interferenze nelle regolazioni di flussi, pressioni e FiO2.”



La Ditta 3C MED (pur avendo a disposizione la possibilità di offrire un nebulizzatore farmaci integrato controllabile tramite il display del ventilatore, come dichiarato dalla stessa 3C MED, e pur dichiarando la 3C MED che questo nebulizzatore integrato sarebbe consigliato in quanto più efficiente e con costi di gestione notevolmente inferiori) offre un ventilatore completo di nebulizzatore esterno denominato Aerogen Solo. Non rispetta pertanto il requisito minimo che richiede un nebulizzatore di farmaci **integrato**, come sopra descritto.

Non può essere accettata l'equivalenza proposta in quanto il fatto che "nella configurazione del ventilatore da noi proposto, il costruttore prevede l'implementazione mediante sistema di nebulizzatore esterna Aerogen" risulta essere una forte limitazione non accettabile dalla Stazione Appaltante, ancor più per il fatto che (a differenza di quanto scritto dalla 3C MED alla pagina 22: "Tutti i maggiori produttori di ventilatori utilizzano il nebulizzatore Aerogen come nebulizzatore elettronico e solo due di essi (GE e Getinge) dispongono dello stesso come nebulizzatore integrato") risulta evidente che ben 4 Ditte offerenti i loro prodotti in questa procedura hanno incluso, come richiesto da Capitolato, un nebulizzatore farmaci integrato collegabile alla Y del circuito tramite apposito adattatore e controllabile tramite il display del ventilatore.

- Il Capitolato Tecnico, al punto 7, richiede:

"Visualizzazione contemporanea di almeno 3 curve in tempo reale e 2 loop in tempo reale (a scelta tra P-V, F-V e F-P), tutti (3 curve + 2 loop) visualizzabili a display in contemporanea, con i parametri ventilatori misurati e calcolati"

Come si evince dagli screenshot inseriti al punto 7 della Relazione Tecnica redatta dalla Ditta 3C MED, il ventilatore proposto non consente la visualizzazione in contemporanea (dunque in un'unica schermata) di almeno 3 curve in tempo reale e 2 loop in tempo reale tutti in contemporanea.

Infatti è chiaramente evidente che è possibile scegliere tra la visualizzazione "Waveforms" e la visualizzazione "Spirometry", ma le due visualizzazioni risultano indipendenti e dunque non è possibile ottenere una visualizzazione complessiva unica di almeno 3 curve in tempo reale e 2 loop in tempo reale tutti in contemporanea.

- Il Capitolato Tecnico, al punto 9, richiede:

"Ventilazione a volume controllato limitata in pressione"

La Ditta offre, in rispondenza a tale requisito, la ventilazione denominata PRVC (pressometrica a volume garantito). Tale tipologia di ventilazione è richiesta in altro punto del Capitolato Tecnico (punto 11) e non è rispondente alla richiesta qui esaminata di "Ventilazione a volume controllato limitata in pressione". Infatti una siffatta modalità di ventilazione dovrebbe avere un'impostazione con la funzione di limitare, per ragioni di sicurezza, la pressione massima (ad es. con acronimo PLimite) in modo tale da garantire il fatto che oltre una certa pressione il ventilatore non si può spingere, pur essendo la modalità controllata in volume.

Basti pensare ad esempio al caso di un paziente con un'ostruzione.

In questa condizione, infatti, il ventilatore cercherà di erogare il volume corrente impostato aumentando, di conseguenza, il valore di pressione, con il rischio di generare un barotrauma. Grazie al "limite di pressione" richiesto, tale evenienza potrà essere evitata.

La modalità PRVC proposta, invece, tra i "Parametri di Ventilazione" non consente di impostare alcuna "PLimite" o acronimo equivalente.



Alla luce di quanto sopra analizzato, il prodotto offerto dalla Ditta 3C MED risulta **non conforme** a quanto richiesto dal Capitolato Tecnico di gara.

Ditta Medigas. Prodotto offerto: Lowenstein ELISA 800
Il prodotto offerto presenta le seguenti non conformità:

- Il Capitolato Tecnico, al punto 7, richiede:

"Visualizzazione contemporanea di almeno 3 curve in tempo reale e 2 loop in tempo reale (a scelta tra P-V, F-V e F-P), tutti (3 curve + 2 loop) visualizzabili a display in contemporanea, con i parametri ventilatori misurati e calcolati"

Il prodotto proposto non consente la visualizzazione in contemporanea (dunque in un'unica schermata) di almeno 3 curve in tempo reale e 2 loop in tempo reale tutti in contemporanea. Infatti tra tutti i modelli di layout display elencati (dal n.1 al n.21) non vi è alcun modello di layout grafico che soddisfa il requisito richiesto.

Si precisa che quanto riportato nella scheda tecnica al punto n.19 non soddisfa quanto richiesto. Infatti il layout grafico esemplificato mostra in maniera chiara che è possibile visualizzare solamente due curve in tempo reale in contemporanea + due loop in tempo reale in contemporanea.

Non a caso, evidentemente, la Ditta scrive a fianco "Visualizzazione fino a tre curve" includendo la parola "fino" che invece è assente in qualsiasi altro modello da n.1 a n.21 descritto, questo per evidenziare, con ogni probabilità, che le tre curve sono personalizzabili ma che, in fin dei conti e come rappresentato dal layout grafico a fianco, solamente due curve in tempo reale in contemporanea + due loop in tempo reale in contemporanea possono essere rappresentati.

- Il Capitolato Tecnico, al punto 11, richiede:

"Ventilazione a pressione controllata a garanzia di volume (PRVC)"

Non si evince in alcuna parte della documentazione tecnica presentata in gara la presenza della modalità controllata richiesta PRVC. Tale modalità, completamente controllata, deve consentire all'operatore di impostare un volume da garantire al paziente applicando, da parte del ventilatore, la minima pressione possibile al fine di raggiungere quel determinato volume.

Inoltre, e più in generale, in aggiunta alle non conformità sopra evidenziate, si sottolinea che è stata prodotta solamente una Relazione Tecnica contenente le "Caratteristiche Generali del Sistema". Non essendo stata prodotta una chiara configurazione dettagliata del sistema offerto in codesta RdO, non è possibile evincere quali siano esattamente le opzioni incluse. Ad esempio non è possibile comprendere se il modulo CO2 è stato incluso o meno in offerta. Infatti nella Relazione generica è scritto: "Il pacchetto software Diagnostico "Capnography" permette il monitoraggio continuo dei valori dell'anidride carbonica espirata (etCO2). E' possibile visualizzare sia i valori numerici sia la curva sul display oltre alla memorizzazione dei trend di tutti i relativi valori. E' disponibile sia la tecnologia MainStream sia quella SideStream. I relativi sensori sono opzionali e ordinabili separatamente."

Ma non è possibile evincere dalla Documentazione Tecnica presentata in gara se effettivamente il pacchetto Diagnostico "Capnography" sia stato o meno incluso in offerta, né tantomeno se siano stati



inclusi o meno i sensori, esplicitamente opzionali e ordinabili separatamente per rilevazione MainStream oppure SideStream.

*Alla luce di quanto sopra analizzato, il prodotto offerto dalla Ditta Medigas risulta **non conforme** a quanto richiesto dal Capitolato Tecnico di gara.*

*Ditta Betafin. Prodotto offerto: Puritan Bennett PB 980
Il prodotto offerto presenta le seguenti non conformità:*

- *Il Capitolato Tecnico, al punto 37, richiede:*

“Sensore di ossigeno non consumabile e completamente esente da manutenzione (ad es. paramagnetico o ad ultrasuoni)”

Non si evince dalla Relazione Punto Punto che il prodotto offerto sia corredato da sensore di ossigeno non consumabile e completamente esente da manutenzione (ad es. paramagnetico o ad ultrasuoni). Si evince invece dalla Scheda Tecnica alla pagina 17/19 che il sensore di ossigeno è di tipologia “a cella chimica” e pertanto che il sensore proposto abbia bisogno di manutenzione in quanto è consumabile.

La dicitura in relazione Punto Punto: “Eventuale manutenzione a carico del servizio assistenza tecnica durante le visite di manutenzione preventiva così come previste dalla lettera di invito.” non può in ogni caso consentire di accettare una tale tipologia di sensore consumabile, anche perché i vantaggi della “non consumabilità” e dell’esonero dalla manutenzione si prolungano di certo per un periodo molto superiore rispetto al periodo richiesto di garanzia (solo periodo in cui le visite di manutenzione preventiva da parte del fornitore sarebbero previste).

- *Il Capitolato Tecnico, al punto 41, richiede:*

“Sistema per la nebulizzazione di farmaci integrato collegabile alla Y del circuito tramite apposito adattatore, controllabile tramite il display del ventilatore per nebulizzazione continua, utilizzabile su pazienti adulti e pediatrici senza interferenze nelle regolazioni di flussi, pressioni e FiO2.”

Come si evince dalla allegata Scheda Tecnica (Burke & Burke) il Modulo di Controllo Aerogen® USB è un sistema portatile (stand alone, dunque non integrato al ventilatore PB 980) per la nebulizzazione continua o intermittente di farmaci durante ventilazione meccanica invasiva e non invasiva, terapia ad alti flussi o respiro spontaneo. In associazione alla camera di nebulizzazione Aerogen® Solo o Pro, il sistema è idoneo per l’utilizzo su neonati, bambini e adulti.

Il nebulizzatore Aerogen Solo incluso nella fornitura non è controllabile dal display del ventilatore, bensì dal Modulo di Controllo (non integrato al ventilatore) Aerogen® USB.

- *Il Capitolato Tecnico, al punto 43, richiede:*

“Funzione dedicata alla bronco-aspirazione, con impostazione della FiO2 pre/post-ossigenazione, sospensione automatica della ventilazione durante la sconnessione del paziente e ripresa automatica della ventilazione alla riconnessione del paziente senza necessità di intervento da parte dell’operatore” Dalla descrizione riportata nella Relazione Tecnica Punto Punto si evince chiaramente che il prodotto offerto non soddisfa il requisito richiesto dal Capitolato Tecnico.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
PRESIDIO OSPEDALIERO "S. GIOVANNI DI DIO" - AGRIGENTO
U.O.C. DI ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA
TERAPIA INTENSIVA COVID
DIRETTORE F.F. DR. G. FIORICA



Alla luce di quanto sopra analizzato, il prodotto offerto dalla Ditta Betafin risulta **non conforme** a quanto richiesto dal Capitolato Tecnico di gara.

Ringraziando anticipatamente, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Agrigento, li 30-03-2021

Dr. G. Fiorica
ASP AGRIGENTO
F.O. SAN GIOVANNI DI DIO
UOC ANESTESIA, RIANIMAZIONE E
TERAPIA INTENSIVA
DIRETTORE F.F. DR. GERLANDO FIORICA

relazione di conformità dopo valutazione schede tecniche relative alla RDO ME.PA. 2769050 per la fornitura di n. 8 ventilatori polmonari per la Terapia Intensiva del P.O. di Agrigento.

Gerlando Fiorica <gerlando.fiorica@aspag.it>

mar 30/03/2021 16:58

A: forniture <forniture@ASPAG.IT>; Oreste Falco <oreste.falco@aspag.it>; Alfonso De Leo <alfonso.deleo@aspag.it>

📎 1 allegati (269 KB)

relazione ventilatori.pdf;

Gent.mi

In allegato, nota di pari oggetto.

Cordialmente

Dr. G. Fiorica

Direttore f.f. UOC Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva

Responsabile U.O. Complesso Operatorio

P.O. San Giovanni di Dio - Agrigento

I suoi dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. "GDPR"), in vigore a decorrere dal 25 maggio 2018. A questo proposito, la invitiamo a prendere visione dell'apposita informativa

Il presente messaggio, corredato da eventuali allegati, contiene informazioni di natura riservata ed è da considerarsi ad utilizzo esclusivo del destinatario. Qualsiasi forma di utilizzo, riproduzione, conservazione, copia, stampa o diffusione non autorizzata del contenuto di questo messaggio o di parte di esso ad opera di soggetti diversi dal destinatario è strettamente vietata. Qualora abbiate ricevuto questo messaggio per errore, siete pregati di avvisare tempestivamente il mittente e di provvedere alla relativa cancellazione unitamente ai contenuti allo stesso allegati



