



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento

## VERBALE DI GARA

**GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA DI N. 62 LETTI DEGENZA ELETTRICI PER VARIE UU.OO.CC. DELL' ASP DI AGRIGENTO – RDO n. 3494656**

**Lotto unico - C.I.G. 972413955B**

L'anno duemilaventitre il giorno nove del mese di novembre, presso la sede degli uffici amministrativi dell'U.O.C. Provveditorato siti in Agrigento viale della Vittoria n. 321

### SONO PRESENTI

i signori, componenti il seggio di gara:

Dott.ssa Maria Tirrò	- Presidente
Dott. Pietro Vitellaro	- Teste
Sig. Giovanni Di Nolfo	- Teste

### PREMESSO

- che con atto deliberativo n. 500 del 16.03.2023 è stata indetta la **GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA DI N. 62 LETTI DEGENZA ELETTRICI PER VARIE UU.OO.CC. DELL' ASP DI AGRIGENTO – Lotto unico - C.I.G. 972413955B**
- che con RDO n. 3494656 è stata pubblicata la gara di cui trattasi sulla piattaforma telematica di negoziazione Consip – MEPA fissando il termine ultimo di presentazione delle offerte per le ore 10:00 del 18.04.2023, successivamente differito al 24.4.2023 ore 10:00 per le motivazioni specificate nel relativo comunicato;
- che la gara è stata prevista come gara aperta a tutti i fornitori abilitati alla categoria merceologica (CPV);
- che con comunicati dei 28.3.2023 e 18.4.2023 sono stati pubblicati chiarimenti di natura tecnica a seguito di richiesta di OO.EE. interessati alla procedura;
- che entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per il 24.04.2023 ore 10:00, sono pervenute le sottoelencate candidature:

**GARDHEN BILANCE**

**HILL-ROM**

**R.D. MEDICAL SRL**

**LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO**

**MIS MEDICAL**

**STRYKER ITALIA SRL SU**

**NOVAMED**

**GIVAS**

**GDM MEDICAL GROUP**

**MALVESTIO SPA**

-che con verbale del seggio di gara del 4.5.2023 si è proceduto a:

“Da atto dell’esame della documentazione amministrativa delle ditte partecipanti come di seguito:

**GARDHEN BILANCE** – conforme

**HILL-ROM** - – conforme

**R.D. MEDICAL SRL** – conforme

**LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO** – conforme

**MIS MEDICAL** – si riscontra la mancanza dei chiarimenti tecnici dei 28.3.2023 e 18.4.2023 sottoscritti digitalmente per accettazione e prodotti in uno alla documentazione

**STRYKER ITALIA SRL** - si riscontra la mancanza dei chiarimenti del 28.3.2023 sottoscritti digitalmente per accettazione e prodotti in uno alla documentazione amministrativa

**NOVAMED** – conforme

**GIVAS** – conforme

**GDM MEDICAL GROUP** – si riscontra la mancanza dei chiarimenti tecnici dei 28.3.2023 e 18.4.2023 sottoscritti digitalmente per accettazione e prodotti in uno alla documentazione amministrativa

**MALVESTIO SPA** – conforme.

Dispone le ammissioni al prosieguo di gara come di seguito specificato:

**GARDHEN BILANCE** – ammessa al prosieguo di gara

**HILL-ROM** – ammessa al prosieguo di gara

**R.D. MEDICAL SRL** – ammessa al prosieguo di gara

**NOVAMED** – ammessa al prosieguo di gara

**GIVAS** – ammessa al prosieguo di gara


**LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO** - ammessa al prosieguo di gara

**MALVESTIO SPA** – ammessa al prosieguo di gara

**MIS MEDICAL** – ammessa con riserva di regolarizzazione ex art. 83 co. 9 D. Lgs. n. 50/2016

**STRYKER ITALIA SRL** – ammessa con riserva di regolarizzazione ex art. 83 co. 9 D. Lgs. n. 50/2016.

**GDM MEDICAL GROUP** – ammessa con riserva di regolarizzazione ex art. 83 co. 9 D. Lgs. n. 50/2016.

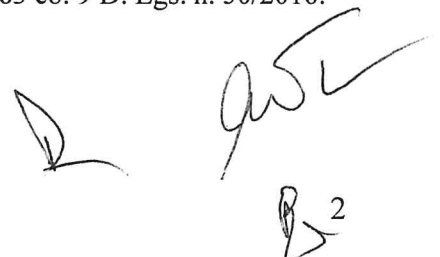Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page. There are two distinct signatures, one appearing to be 'AST' and another below it. Below the signatures are some initials and the number '2'.

Da atto che con apposite comunicazioni tramite piattaforma Consip/Mepa le società ammesse con riserva verranno invitate a regolarizzare la documentazione amministrativa riscontrata carente nel termine che verrà ivi indicato.

Da, altresì, atto della mera apertura dei files contenenti la documentazione tecnica di gara al fine di trasmetterli all'Organo tecnico/specialista tecnico di supporto al RUP che verrà all'uopo nominato.

Chiude la presente seduta di gara per consentire le predette regolarizzazioni e la verifica tecnica da parte degli specialisti/organo tecnico di supporto al RUP.

Dispone la pubblicazione del presente verbale sul sito dell'ASP e sulla piattaforma telematica Consip.”

Tutto ciò premesso

#### IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la gara.

Da atto che la società MIS MEDICAL, GDM MEDICAL GROUP e STRYKER ITALIA SRL hanno regolarizzato la documentazione amministrativa come da verbale del 4.5.2023. pertanto viene sciolta la riserva a carico delle stesse e vengono ammesse al prosieguo di gara.

Da atto che con prot. 70021 del 5.5.2023 è stata trasmessa la documentazione tecnica degli OO.EE. partecipanti all'organo tecnico di supporto al RUP per le conseguenziali valutazioni di competenza.

Prende atto del contenuto del **verbale tecnico ex prot. 167312 del 9.11.2023** – allegato – di cui dà pubblica lettura, riportandone di seguito, sinteticamente, i contenuti:

**GARDHEN BILANCE** – conforme

**HILL-ROM** - conforme

**R.D. MEDICAL SRL** – non conforme

**LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO** – non conforme

**MIS MEDICAL** – conforme

**STRYKER ITALIA SRL** - non conforme

**NOVAMED** – conforme


**GIVAS** – non conforme

**GDM MEDICAL GROUP** – non conforme

**MALVESTIO SPA** – conforme.

Per quanto riportato nel verbale tecnico prot. 167312 del 9.11.2023:




**- ammette al prosieguo di gara, fase apertura offerte economiche, le società GARDHEN BILANCE, HILL-ROM, MIS MEDICAL, NOVAMED e MALVESTIO SPA in quanto giudicate conformi tecnicamente;**

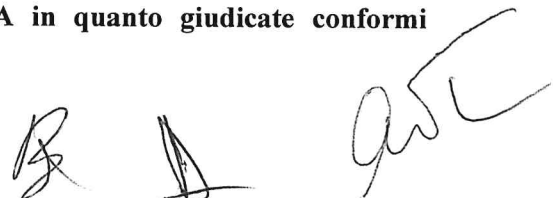


**- esclude dal prosieguo di gara, fase apertura offerte economiche, gli OO.EE. R.D. MEDICAL SRL, LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO, STRYKER ITALIA SRL, GIVAS e GDM MEDICAL GROUP in quanto giudicate non conformi tecnicamente.**

Sospende la seduta di gara per procedere alle notifiche delle ammissioni ed esclusioni di cui avanti è cenno, nonché le pubblicazioni di rito sul sito dell'ASP e sulla piattaforma telematica Consip.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE   
IL TESTE   
IL TESTE 

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO  
PRESIDIO OSPEDALIERO DI AGRIGENTO  
U.O.C. DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA  
DIRETTORE DR.SSA M.R. FALCO ABRAMO



Prot. N. 167312 del 9/11/2023

Al Direttore UOC Provveditorato  
Dr.ssa C. Schinelli

Oggetto: valutazione schede tecniche RDO per acquisto letti da degenza.

Dopo valutazione delle schede tecniche fornite dagli O.E. in relazione alla gara in oggetto, si descrivono di seguito le risultanze derivanti dal confronto di quanto offerto e di quanto richiesto dal capitolato di gara:

Ditta GARDHEN BILANCE: Prodotto offerto Letto Gardhenia.

Caratteristiche corrispondenti al capitolato di gara. Pertanto, si ritiene **CONFORME**.

Ditta GDM MEDICAL GROUP: Prodotto offerto Letto serie 4303 – PSILIAKOS:

- richiesta la caratteristica "Altezza variabile tra circa 40 e 80 cm con led di indicazione di altezza minima di sicurezza sotto il letto". Il letto non presenta Led indicatore di altezza minima.
- Richiesta la caratteristica "Sponde in monoscocca a 2 settori per lato, con movimento di abbattimento servo-assistito e che non occupino molto spazio quando abbassate. Facilmente lavabili e disinfettabili in ogni loro parte e meccanismo. Le sponde devono avere un'impugnatura che faciliti i movimenti del paziente in fase di salita e discesa dal letto". Le sponde offerte non posseggono il sistema servo-assistito per l'abbattimento così come richiesto nel CSA. Infatti sia nella scheda tecnica che nel manuale non è presente questa caratteristica.
- Richieste le posizioni: trendelenburg, anti-trendelenburg, poltrona cardiologica, uscita facilitata, azionabili solo dalla pulsantiera operatore o bloccando il comando sulla pulsantiera paziente. Il letto non possiede la posizione di uscita facilitata.
- Richiesto il Gancio di fissaggio per il cavo dell'alimentazione elettrica. Non è presente il gancio per il fissaggio del cavo dell'alimentazione elettrica.

Per quanto sopra esposto è da ritenersi **NON CONFORME**.

Ditta GIVAS: Prodotto offerto Letto modello VEGA.


Richiesta la caratteristica di inclinazione della sezione gambali ad almeno 20°. Dalla scheda tecnica si evince inclinazione fino a 16°.

Pertanto, si ritiene **NON CONFORME**.

Ditta HILL ROM: Prodotto offerto Letto modello HR900.

Caratteristiche corrispondenti al capitolato di gara. Pertanto, si ritiene **CONFORME**.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO  
PRESIDIO OSPEDALIERO DI AGRIGENTO  
U.O.C. DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA  
DIRETTORE DR.SSA M.R. FALCO ABRAMO

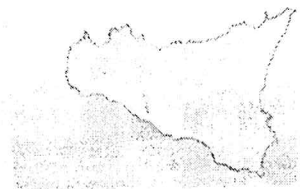

Ditta LINET: Prodotto offerto Letto modello ELEGANZA 1.

- Richieste le posizioni: trendelenburg, anti-trendelenburg, poltrona cardiologica, uscita facilitata, azionabili solo dalla pulsantiera operatore o bloccando il comando sulla pulsantiera paziente. Il letto non possiede la posizione di uscita facilitata.

Per quanto sopra esposto è da ritenersi **NON CONFORME**.

Ditta MALVESTIO: Prodotto offerto Letto modello DELTA 4 Cod. 3710.

Caratteristiche corrispondenti al capitolato di gara.

Pertanto, si ritiene **CONFORME**.

Ditta MIS MEDICAL: Prodotto offerto Letto modello SMART 600 Cod. LH620E.

Caratteristiche corrispondenti al capitolato di gara.

Pertanto, si ritiene **CONFORME**.

Ditta NOVAMED: Prodotto offerto Letto modello GUESS 402 di prod KENMAK.

Caratteristiche corrispondenti al capitolato di gara.

Pertanto, si ritiene **CONFORME**.


Ditta R.D. MEDICAL: Prodotto offerto Letto modello CURA 4040 di prod SCHRODER.

- Richieste Posizioni: trendelenburg, anti-trendelenburg, poltrona cardiologica, uscita facilitata, azionabili solo dalla pulsantiera operatore o bloccando il comando sulla pulsantiera paziente. Riferendosi ai punti indicati dalla Rispondenza inserita nella busta tecnica dove vengono indicati i punti n°22 e 23 della pag. 8 e il punto 21 della pag. 7 della Relazione tecnica e di conseguenza, andando ad analizzare i suddetti punti, non si riscontra la presenza dell'uscita facilitata. Infatti la Ditta dichiara la presenza di maniglie integrate per facilitare l'entrata e l'uscita del paziente ma non la posizione di uscita facilitata come richiesto dal capitolato.

Per quanto sopra esposto è da ritenersi **NON CONFORME**.

Ditta STRYKER: Prodotto offerto Letto modello SV2.

- Richiesto 4 ruote gemellate di diametro 150 mm, di cui almeno 2 piroettanti, 1 antistatica e bloccaggio centralizzato sia totale che direzionale azionabile su tutte le ruote con leve a doppio braccio o unica barra. Dall'analisi della documentazione tecnica non si comprende qual è il letto offerto in gara se trattasi del letto SV2 o SV2 Package Plus o SV2 Complete. Vengono descritte a pag. 15 tutti gli elementi inclusi nelle 3 configurazioni ma non specificano quale delle 3 configurazioni è quella offerta in gara. Infatti la scheda tecnica risulta parecchio generica tanto da indicare in alcuni punti, come ad esempio a pag. 4 relativamente alla caratteristica Luce Notturna sotto al letto, per la quale si legge chiaramente che si tratta di un elemento opzionale nel modello SV2 base e di serie nel modello SV2 Complete, senza chiarire quale dei due è stato realmente offerto. Inoltre a pag. 7 della scheda tecnica le ruote gemellari da 150 mm vengono offerte come opzionali.
- Richiesto Schienale elevabile elettricamente (chiarim: di almeno 63°). Vedasi pag. 9 della scheda tecnica. Il letto offerto possiede un'inclinazione della schiena da 0 a 60° difforme da quanto



chiarito in sede di gara attraverso i chiarimenti pubblicati che stabiliva un'inclinazione della sezione schiena di almeno 63°. Si riscontra però che nel dépliant è riportata un'inclinazione da 0 a 65° ma senza alcun riferimento alla tipologia di modello.

- Richiesto Posizioni: trendelenburg, anti-trendelenburg, poltrona cardiologica, uscita facilitata, azionabili solo dalla pulsantiera operatore o bloccando il comando sulla pulsantiera paziente. Vedasi pag. 9 della scheda tecnica dove si legge chiaramente che i gradi di inclinazione del trend e dell'anti-trendelenburg è pari a +/- 12° difforme da quanto meglio specificato con i chiarimenti pubblicati che stabilivano l'inclinazione del trend ed antitrend di almeno +/-15° circa.
- Richiesto Tastiera e pediera in materiale plastico, facilmente asportabili e sistema di blocco di sicurezza antisfilamento. Vedasi pag. 7 della scheda tecnica. La Stryker dichiara che la testiera e la pediera del letto offerto presenta un sistema di inserzione profondo che ne impedisce la fuoriuscita accidentale. Tale caratteristica è difforme da quanto richiesto dal Capitolato che prevedeva la presenza di un sistema di bloccaggio della pediera e della testiera caratteristica non presente nel prodotto offerto.
- Richiesto Allarme acustico in caso di freno non inserito e letto collegato alla rete elettrica. vedasi pag. 8. Il letto offerto dalla Stryker non presenta l'allarme acustico di letto non frenato ma, come specificano, un allarme visivo rappresentato da codice colore (rosso) sui 4 pedali per letto non frenato. A seguito di chiarimenti pubblicati è stato definito che l'allarme acustico richiesto è un requisito minimo indispensabile.
- Richiesto Predisposizione del piano allunga letto nella sezione piedi senza che sia necessario togliere la pediera. Vedasi pag. 4. Non si capisce se tale caratteristica è presente o meno visto che trattasi di un'opzione per il modello SV2 e di serie per il modello SV2 Complete senza specificare quale dei due modelli è quello offerto.
- Richiesto il Gancio di fissaggio per il cavo dell'alimentazione elettrica. Non è presente il gancio per il fissaggio del cavo dell'alimentazione elettrica.
- Richiesto Alloggiamento per bombola di ossigeno. A pag. 10 è presente un elenco di porta bombole ma non specificano quale dei modelli proposti verrà offerto.
- Richiesto Asta portaflebo a 4 ganci, in grado di sostenere sacche da 5 litri, con ganci in acciaio, regolabili in altezza. A pag. 9 e 10 sono presenti 2 modelli di asta flebo ma non specificano quale dei due è offerto.
- Richiesto Portapadelle. Non si riscontra il portapadelle richiesto dal capitolato.

Per quanto sopra esposto, il prodotto si ritiene **NON CONFORME**

Agrigento, 03-11-2023

Dr. S. Incandela

Dr. ssa M.R. Falco Abramo  
AZ SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO  
PRES OSPEDALIERO AGRIGENTO  
U.O.C. OSTETRICIA GINECOLOGIA  
DR. MARIARITA FALCO ABRAMO AG3567  
CODICE FISCALE FLCART71P49H1480  
CIRCOL. EMPAM: 300219117T

